



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

DETERMINA N° 190 / Dipartimento M. A. A./Ufficio A. B. e S.

Oggetto: Indizione procedura negoziata per la Fornitura di n.1 Defibrillatore Multiparametrico per l'Unità Operativa di Oncologia del Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotone.

COD.CIG. Z6B1D25939

In data 06 FEB.2017, nella Sede del Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A. B. e S., sita in Crotone c/o Centro Direzionale "Il Granaio" di Via M. Nicoletta;

Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Dirigente Responsabile del competente Ufficio;

Acquisito il parere di regolarità contabile;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
MACRO AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che il Direttore dell'U.O. di Oncologia del Presidio Ospedaliero di Crotone, ha inoltrato richiesta per la Fornitura di n.1 Defibrillatore Multiparametrico;

VERIFICATO che la Consip S.p.A. non ha attualmente attivato convenzioni per l'acquisto dei beni di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire;

RITENUTO, pertanto, che si deve fare ricorso ad una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D.lgs. 50/2016, per la Fornitura di n.1 Defibrillatore Multiparametrico per l'Unità Operativa di Oncologia del Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotone, per una spesa complessiva presumibile di Euro 19.000,00, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

VISTA la Delibera 030 del 26/01/2017 di questa Azienda Sanitaria Provinciale avente ad oggetto gli Obiettivi di Piano, Linea Progettuale 2 - Sicurezza e Rischio Clinico;

VISTO l'art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, che consente alle Stazioni Appaltanti di effettuare gli acquisti, per via elettronica e telematica interamente gestiti dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, attuando la procedura della Richiesta di Offerta (RDO);

DETERMINA

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1. INDIRE procedura negoziata per Fornitura n.1 Defibrillatore Multiparametrico per l'Unità Operativa di Oncologia del Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotona, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
2. AUTORIZZARE l'Ufficio Acquisizione Beni e Servizi a procedere all'acquisto per via telematica tramite il Sistema gestito dal MePa, mediante la procedura della Richiesta di offerta (RDO);
3. APPROVARE la Lettera di invito ed il Capitolato Tecnico che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante;
4. DARE ATTO che la spesa presunta di Euro 19.000,00 oltre Iva sarà impegnata al momento dell'aggiudicazione;
5. Nominare Responsabile del procedimento il Dott. Giancarlo Pizzuti ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016;

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Giancarlo Pizzuti




Il Direttore f.f. Ufficio A.B e S.

Dott.ssa Paola Grandinetti



Il Direttore del Dipartimento M.A.A.

Dott. Francesco Saverio Loria

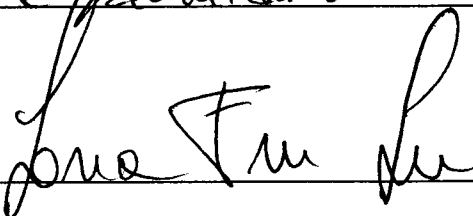

=====

UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 06 FEB.2017 con protocollo n. 357

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino



Il Direttore f.f. Ufficio
Affari Generali e Legali
Dr.ssa *Anna Giordano*

=====

RDO per la fornitura di un Defibrillatore Multiparametrico per l'Unità Operativa di Oncologia del Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotone.

PREZZO A BASE D'ASTA: Euro 19.000,00

COD.CIG. Z6B1D25939

Questa Azienda Sanitaria Provinciale indice una Procedura Negoziata per la fornitura di un Defibrillatore Multiparametrico per l'Unità Operativa di Oncologia del Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotone;

La ditta che intende partecipare alla suddetta procedura, dovrà presentare offerta, con allegate le schede tecniche e la descrizione dettagliata dei requisiti in conformità alle caratteristiche minime di cui al Capitolato Tecnico allegato alla presente; potranno essere presentate offerte con caratteristiche equivalenti accompagnate da adeguata relazione con la quale si dimostri che l'articolo offerto è in grado di ottenere gli stessi risultati di quello richiesto.

Si chiede, pertanto, di voler predisporre offerta tecnica con allegate le schede del prodotto, la descrizione dello stesso, le specifiche tecniche e dimensioni e tutte le informazioni necessarie per valutare il prodotto offerto.

Normativa anticorruzione

Ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012, la ditta concorrente dovrà sottoscrivere in calce ed ogni sua pagina, il PATTO DI INTEGRITA' allegato alla presente.

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il Patto di integrità verrà richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 così come modificato dalla Legge n. 190/2012 il concorrente deve rendere apposita dichiarazione come da modello allegato alla presente.

La ditta, inoltre, dovrà inviare il deposito cauzionale provvisorio pari al 2% del prezzo a base d'asta, costituito nei modi di legge.

L'offerta dovrà essere intestata a: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE - Via Mario Nicoletta Centro Direzionale "Il Granaio" - CROTONE.

Le ditte partecipanti dovranno allegare alla RDO la seguente documentazione:

Documentazione Amministrativa :

- Lettera di invito e Capitolato Tecnico controfirmati per accettazione dal legale Rappresentante della ditta o suo delegato;
- deposito cauzionale provvisorio pari al 2% del prezzo a base d'asta di Euro 19.000,00;
- Impegno di sottoscrizione polizza definitiva in caso di aggiudicazione come per legge.

- Modello sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina del Patto di Integrità, ex art. 1, comma 17, Legge 190/2012;
- Modello compilato e sottoscritto ex art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001;

Documentazione OFFERTA TECNICA :

- Schede Tecniche e Deplianti dei prodotti offerti.

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, a favore della ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa. Per la determinazione del punteggio verrà nominata la Commissione giudicatrice che valuterà le offerte sulla base degli elementi di cui alla seguente griglia:

QUALITA' MAX punti 60

Griglia di valutazione dell'offerta tecnica – PUNTI 60/100	Punteggio
a) Stimolatore transtoracico di alta qualità che prevede l'utilizzo di impulsi a corrente costante di 40 millisecondi (massima percentuale di cattura con minimo impiego di corrente). Lo stimolatore deve funzionare sia in modalità sincrona sia In modalità asincrona rispetto all'ECG del paziente.;	Minimo 0 Max 15
b) Il defibrillatore deve essere dotato di algoritmo di filtraggio del rumore elettrico provocato dalle compressioni manuali sull'ECG, in grado di mostrare la traccia ECG effettiva del paziente anche durante le manovre di RCP;	Minimo 0 Max 10
c) Il defibrillatore In modalità' semiautomatica deve automaticamente settarsi per pazienti Adulti, Pediatrici e Neonatali, con protocolli di scarica dedicati per ciascuna categoria che si attivino automaticamente una volta selezionato il tipo di paziente;	Minimo 0 Max 10
d) Il defibrillatore deve essere in grado di memorizzare almeno 24 ore di trend vitali con intervallo di 1 minuto,1000 (mille) eventi con indicazione temporale e 32 snapshot di 24 secondi l'uno. Inoltre in un registro separato, almeno 32 snapshot di acquisizioni a 12 derivazioni;	Minimo 0 Max 10

e) Tecnologia di misurazione della pressione arteriosa con tubo di misurazione doppia, in grado di eseguire la misurazione della pressione del paziente durante la fase di gonfiaggio della cuffia, con evidente risparmio di tempo per la misura, fastidio per il paziente e consumo della batteria;	Minimo 0 Max 15
---	--------------------

Il punteggio assegnato dalla Commissione giudicatrice verrà inserito al Sistema manualmente.

PREZZO MAX punti 40

I prezzi dovranno essere indicati al netto dell’IVA. Il prezzo offerto è da intendersi comprensivo del costo della garanzia per un periodo di mesi 24 full risk.

Il punteggio economico verrà attribuito all’offerta economica totale calcolata automaticamente dal Sistema applicando la formula non lineare a proporzionalità inversa interdipendente.

L’Azienda si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente.

La consegna dovrà avvenire non oltre giorni 15 dalla data dell’invio del documento di stipula.

Il pagamento avverrà, previo riscontro dell’Ufficio competente, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della fattura che dovrà, come per legge, essere trasmessa in formato elettronico al seguente codice univoco: **ACIZEO** .

Modalità di consegna e pagamenti

La consegna dello strumento dovrà essere effettuata presso la Struttura interessata.

L’importo offerto si intende comprensivo della fornitura degli articoli con le caratteristiche tecniche indicate in offerta, del trasporto, consegna da concordare con il Direttore dell’Unità Operativa di Oncologia del Presidio Ospedaliero.

La Ditta aggiudicatrice si obbliga ad adempiere a quanto disposto dall’art. 3 della legge n. 136/2010 “Tracciabilità flussi finanziari”, mediante apertura di conto corrente bancario o postale, dedicato ai movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, comunicando alla Amministrazione, ai sensi del suddetto articolo, comma 7, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il mancato adempimento di tutto quanto previsto dalla richiamata norma comporterà la risoluzione di diritto del contratto stipulato, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., senza necessità di costituzione in mora.

Distinti saluti

Ufficio Acquisizione Beni e Servizi
F.to Dott.ssa Paola Grandinetti

Firma e timbro per accettazione



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

CAPITOLATO TECNICO

RDO per la fornitura di un Defibrillatore Multiparametrico per l'Unità Operativa di Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva del Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotone.

PREZZO A BASE D'ASTA: Euro 19.000,00

COD.CIG. Z6B1D25939

Monitor Defibrillatore Multiparametrico con le seguenti caratteristiche minime:

- Onda di defibrillazione rettilinea o troncata esponenziale bifasica, con adattamento attivo all'impedenza del paziente che consenta una defibrillazione a corrente costante nella prima fase dell'onda, efficace anche a basse energie su pazienti ad alta impedenza.
- Stimolatore transtoracico di alta qualità (massima percentuale di cattura con minimo impiego di corrente). Lo stimolatore deve funzionare sia in modalità sincrona sia in modalità asincrona rispetto all'ECG del paziente.
- Batteria unica priva di effetto memoria, con indicatore di carica residua in termini temporali. Un'unica batteria a piena carica deve consentire l'utilizzo dell'apparecchio per almeno 6 ore ed un numero elevato di scariche alla massima energia (almeno 250 scariche).
- Peso dell'unità contenuto (massimo 6 Kg compresa batteria) e dimensioni compatte e contenute. Maniglia per il trasporto comoda e dotata di ganci per barella.
- Il defibrillatore deve essere resistente agli urti ed alle cadute (certificato per cadute da 2 metri almeno 25 volte), e possedere un elevato valore IP per la penetrazione da solidi e liquidi (almeno IP55).
- Ampio monitor a colori (almeno 6,5 pollici) con possibilità di visualizzazione di 4 tracce contemporaneamente (ECG e/o parametriche), valori numerici dei parametri misurati.
- Il monitor dell'apparecchio deve essere ben visibile anche all'aperto (illuminazione solare diretta) e possedere modalità di visualizzazione differenti in n modo da poterne ottimizzare la visibilità a seconda delle condizioni di illuminazione.
- Il defibrillatore deve essere dotato di indicatore di stato Pronto all'Uso.
- Stampante termica con larghezza carta pari ad 80 mm. La carta della stampante deve possedere una lunghezza tale da consentire la stampa ininterrotta di almeno 20 minuti di ECG.
- Modulo per il supporto nelle fasi di RCP. Il defibrillatore deve essere in grado di supportare il medico durante l'esecuzione della RCP, attraverso messaggi vocali, valori numerici e rappresentazioni grafiche relative a profondità e frequenza delle compressioni e al completo rilascio della cassa toracica. Tali valori e rappresentazioni devono essere ben visibili e di attivazione automatica dopo le prime compressioni del medico.

- Il defibrillatore deve essere dotato di algoritmo di filtraggio del rumore elettrico provocato dalle compressioni manuali sull'ECG, in grado di mostrare la traccia ECG effettiva del paziente anche durante le manovre di RCP.
- Il Defibrillatore in modalità semiautomatica deve automaticamente settarsi per pazienti Adulti, Pediatrici e Neonatali, con protocolli di scarica dedicati per ciascuna categoria che si attivino automaticamente una volta selezionato il tipo di paziente.
- Il Defibrillatore deve possedere protocolli di monitoraggio distinti per pazienti Adulti, Pediatrici e Neonatali, con protocolli di scarica dedicati per ciascuna categoria che si attivino automaticamente una volta selezionato il tipo di paziente.
- Memoria interna di grande capacità esportabile mediante dispositivi di semplice utilizzo (tipo USB). La memoria deve possedere un'elevata capacità di memorizzazione di eventi, dati paziente, ECG 12 derivazioni... (circa 1000 eventi, 30 registrazioni ECG 12 derivazioni e 24 ore di dati ad intervallo di un minuto e 30 registrazioni istantanee). L'apparecchio deve essere dotato di funzione di memorizzazione di tipo "istantanea" tramite apposito pulsante, con capacità di memoria retroattiva rispetto alla pressione del tasto di almeno 10 secondi e successiva alla pressione di altri 10 secondi (almeno 20 secondi totali ad ogni pressione del tasto). La lettura dei dati memorizzati deve avvenire su apposito software che non comporti alcun costo aggiuntivo.
- Modulo per la rilevazione della saturazione arteriosa periferica di ossigeno (SpO2). Il modulo deve consentire il monitoraggio dei parametri anche in condizioni di scarsa perfusione e movimento.
Il defibrillatore deve mostrare la traccia della SpO2 ed i valori numerici di tutti i parametri misurati.
- Modulo per la rilevazione della pressione arteriosa non invasiva (NIBP) che consenta la misurazione della stessa anche in fase di gonfiaggio della cuffia pneumatica. Per le misurazioni della pressione arteriosa in fase di sgonfiamento della cuffia, il modulo NIBP deve essere dotato di algoritmo di rilevazione degli artefatti da movimento sincronizzato all'ECG del paziente.
- Il defibrillatore deve essere in grado di memorizzare almeno 24 ore di trend vitali con intervallo di 1 minuto, 1000 (mille) eventi con indicazione temporale e 32 snapshot di 24 secondi l'uno. Inoltre in un registro separato, almeno 32 snapshot di acquisizioni a 12 derivazioni.
- Tecnologia di misurazione della pressione arteriosa con tubo di misurazione doppia, in grado di eseguire la misurazione della pressione del paziente durante la fase di gonfiaggio della cuffia, con evidente risparmio di tempo per la misura, fastidio per il paziente e consumo della batteria.
- Sistema di misurazione ETCO2 . Il sistema deve essere utilizzabile per le misurazioni di CO2 in pazienti neonati, pediatrici e adulti intubati e non intubati.
- Completo di Piastre Rigide con Piastre Pediatriche Incorporate.
- Completo di piastre monouso a gel liquido

Ufficio Acquisizione Beni e Servizi

F.to Dott.ssa Paola Grandinetti

Firma e timbro per accettazione
