

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DETERMINA N° 1145 /DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA/Ufficio A. B. e S.

Oggetto: Indizione procedura negoziata per l'acquisto N. 3 Ventilatori per anestesia, per l'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero di Crotone.

In data **09 SET. 2015**, nella Sede del Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A. B. e S., sita in Crotone c/o Centro Direzionale "Il Granaio" di Via M. Nicoletta; Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Dirigente Responsabile del competente Ufficio;
Acquisito il parere di regolarità contabile;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che il Direttore della Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero di Crotone, ha avanzato richiesta per l'acquisto di n. 3 ventilatori da ubicare nelle due sale TAC ed in Gastroenterologia, autorizzata in calce dal Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza Accettazione;

CHE alla predetta richiesta è stata allegato il relativo Capitolato Tecnico;

CHE il Commissario Straordinario, con nota Prot. N. 63990 del 21/08/2015 ha richiesto all'Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante la necessità di espletare la relativa gara;

CHE la predetta Autorità Regionale con nota Prot. N. 0251617 del 24/08/2015 ha autorizzato questa ASP a provvedervi direttamente;

VISTE le caratteristiche tecniche delle suddette apparecchiature e le tabelle di valutazione qualitativa, predisposte dal Direttore della Struttura interessata;

VERIFICATO che la Consip S.p.A. non ha attualmente attivato Convenzioni per la fornitura dei beni di cui all'oggetto;

CHE sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione non risultano presenti nelle categorie contemplate apparecchiature con le caratteristiche richieste;

RITENUTO, pertanto, che si debba fare ricorso ad una Procedura Negoziata ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs. N. 163/06, per l'acquisto N. 3 ventilatori da ubicare nelle due sale TAC ed in Gastroenterologia del Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotone, per una spesa presumibile di Euro 105.000,00, da aggiudicarsi col sistema prezzo-qualità ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. N. 163/06;

CONSIDERATO che le Stazioni Appaltanti sono tenute al versamento delle tasse di gara in relazione al valore, giusta deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 03-11-2010;

VISTA la lettera d'invito predisposta dall'Ufficio Acquisizione Beni e Servizi ed il Capitolato Tecnico redatto dal Primario dell'U.O.C. di Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva del Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotone che, allegati alla presente, ne formano parte integrante;


VISTO il Regolamento per l'Acquisizione in Economia di Beni e Servizi, approvato con Delibera N. 639 del 07/11/2012 ed integrato con Delibera N. 077 del 06/02/2013;

DETERMINA

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1. INDIRE procedura negoziata per l'acquisto N. 3 ventilatori da ubicare nelle due sale TAC ed in Gastroenterologia del Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotone, per una spesa presumibile di Euro 105.000,00, da aggiudicarsi col sistema prezzo-qualità ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. N. 163/06;
2. APPROVARE il Bando e l'allegato A riportante le caratteristiche tecniche delle apparecchiature che, uniti alla presente, ne costituiscono parte integrante;
3. AUTORIZZARE l'Ufficio Acquisizione Beni e Servizi alla pubblicazione del bando sul sito web dell'Azienda;
4. DARE ATTO che la spesa presumibile di Euro 105.000,00 oltre IVA sarà impegnata al momento dell'aggiudicazione;
5. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria al versamento di Euro 225,00 in favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, mediante MAV (pagamento mediante avvisi) secondo le modalità di cui alla deliberazione AVCP del 03-11-2010 e s.i.m., previo impegno di spesa sul Conto 101.2.401 del Bilancio;
6. NOMINARE Responsabile del Procedimento il Dott. Giancarlo Pizzuti;


Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giancarlo Pizzuti



Il Direttore f.f. Ufficio A. B. e S.
Dott.ssa Paola Grandinetti



Il Direttore del Dipartimento Area Amm.va
Dott. Francesco Saverio Loria

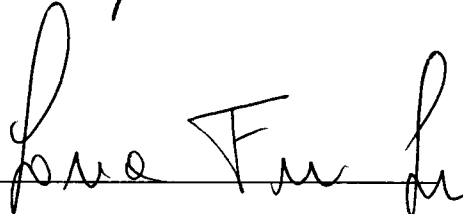

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Determina/Delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 09 SET. 2015 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 2131 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino


Il Direttore f.f. Ufficio
Affari Generali e Legali
Dr.ssa Anna Giordano

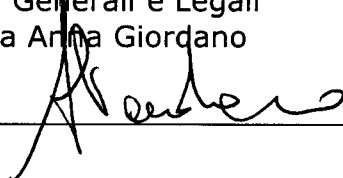



UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
TEL. 0962-924091 – Telefax 0962-924992
PEC: ufficioabes@asp.crotone.it

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Oggetto: Procedura Negoziata per l'acquisto di n. 3 Ventilatori per anestesia da destinare nelle due sale TAC ed in Gastroenterologia del Presidio Ospedaliero di Crotone.

Questa Azienda Sanitaria Provinciale indice una procedura negoziata per l'acquisto di n. 3 Ventilatori per anestesia da destinare nelle due sale TAC ed in Gastroenterologia del Presidio Ospedaliero di Crotone, aventi le caratteristiche minime così come indicate nell'allegato A - CAPITOLATO TECNICO.

N. 3 Ventilatori per anestesia – IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA EURO 105.000,00

Le ditte interessate dovranno presentare la propria offerta per come segue:

L'offerta, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore ... del giorno .././20.. all'Ufficio Protocollo Generale dell'ASP, Via Mario Nicoletta – CENTRO DIREZIONALE “IL GRANAIO” – Scala B – Piano 3° int. B1 – 88900 CROTONE.

Il plico sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura dal legale rappresentante, oltre all'indirizzo del mittente e del destinatario, dovrà recare, ben visibile, la seguente dicitura: “UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI – OFFERTA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISTO DI N. 3 VENTILATORI PER ANESTESIA PER L'UNITA' OPERATIVA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE”

All'interno del plico dovranno essere inserite n. 3 buste, opportunamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura con scritto “**Contiene Documentazione Amministrativa**”; “**Contiene Documentazione Tecnica**” e “**Offerta Economica**”.

- 1- Il plico “documentazione amministrativa” dovrà contenere:
Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, a firma del legale rappresentante dalla quale risulti:
 - La iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività in oggetto;
 - Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, a firma del legale rappresentante indicante l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter) e m-quarter) del D.Lgs. 163/06;
 - Dichiarazione attestante la regolarità degli adempimenti INPS-INAIL (DURC);
 - Deposito cauzionale provvisorio nei modi di legge, di Euro 2.100,00 pari al 2% del valore massimo complessivo dell'offerta;
 - Copia del presente bando e dell'allegato “A” sottoscritti per accettazione dal Titolare o Legale Rappresentante della ditta offerente;
 - Dichiarazione nella quale risulta che la ditta in caso di aggiudicazione garantirà, compresa nel prezzo di fornitura, l'assistenza full-risk per 24 mesi dalla data del collaudo;

2- Documentazione da inserire nell'offerta tecnica:

- Schede tecniche e deplianti illustrativi delle apparecchiature offerte, in lingua italiana;
- Fotocopia dell'offerta riportante la composizione delle apparecchiature omettendo, ovviamente, di riportare i prezzi;

3- Offerta economica:

La ditta nel prezzo dell'apparecchio offerto dovrà comprendere il costo della manutenzione full-risk per 24 mesi dalla data di collaudo.

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'Art. 83 del D.Lgs. N. 163/06, a favore della ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base degli elementi di cui alla seguente griglia:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE qualità tecniche e funzionali max punti 60

- | | |
|--|---------------------|
| - Flussimetri digitali su display separato (mantenendo lo schema dei respiratori tradizionali per un approccio immediato allo strumento) | max 3 punti |
| - Spirometri con sensore alla Y del paziente | max 5 punti |
| - Grado di visibilità e caratteristiche della concertina | max 2 punti |
| - Monitor con comandi respiratorie touch screen | max 10 punti |
| - Test perdite e compliance rapido (indicare il tempo da accesso a pronto) | max 10 punti |
| - Monitor totalmente touch screen | max 5 punti |
| - Allarmi ad alta visibilità (visibili anche dal retro del monitor) | max 5 punti |
| - Durata dei trend | max 5 punti |
| - Funzione numeri grandi per visibilità a distanza | max 5 punti |
| - Modulo GAS: | |
| - Volume di campionamento ed auto calibrazione | |
| - Tempo di riscaldamento | max 5 punti |
| - Assistenza operativa: | |
| - Numeri di intervento nell'arco di 1 anno per manutenzione programmata | |
| - Tempo massimo di intervento dalla chiamata per risoluzione guasti | |
| - Sede centro assistenza tecnica più vicino con magazzino pezzi di ricambio | |
| - Qualifica, nome e cognome del tecnico dedicato | max 5 punti |

Si precisa che, non saranno ammessi alla fase finale alla procedura, i concorrenti le cui offerte non avranno conseguito almeno 36 punti sulla qualità.

Risulterà vincitrice la ditta che avrà conseguito il maggior punteggio prezzo/qualità globale.

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente.

La consegna, installazione e collaudo delle apparecchiature dovrà avvenire entro gg. 15 dall'ordine. La fattura che dovrà pervenire in formato elettronico al codice univoco ACIZEO, dovrà essere emessa dopo l'avvenuto collaudo, ed il pagamento avverrà entro sessanta giorni dalla data di ricezione dopo il riscontro dell'Ufficio Competente.

Ufficio Acquisizione Beni e Servizi
Il Responsabile del procedimento
F.to Dott.ssa Paola Grandinetti

ALLEGATO A

Descrizione Caratteristiche minime Ventilatori per anestesia:

- Doppio alloggiamento per vaporizzatori;
- Ventilazioni minime richieste: Man e Spontaneo, CMV, PCV, SIMV, SIMV+PS, PS;
- Monitor a colori integrato per la visualizzazione dei parametri respiratori, curve di pressione;
- Curva di flusso, Loop respiratori, FiO₂, gas freschi, con allarmi su tali parametri e per i comandi del ventilatore;
- Dotato di trigger di flusso;
- Compensazione della compliance e delle perdite per un sicuro utilizzo a bassi e bassissimi flussi;
- Concertina ascendente ben visibile;
- Flussimetri digitali con massima accuratezza per bassi e bassissimi flussi, con sistema di prevenzione miscele ipossiche;
- testata paziente facilmente smontabile e sterilizzabile;
- Fonte di O₂ supplementare di gas fresco regolata da flussimetro;
- Uscita miscela gas per collegamento a va e vieni per manovre di induzione;
- Presenza di batteria tampone con circa 30 min di autonomia in caso di mancanza di alimentazione elettrica;
- Sistema evacuazione gas presente con compensazione;
- Regolatore di vuoto integrato per la raccolta di liquidi biologici;
- Monitor a colori modulare con schermo di almeno 10" touch screen con comunicazione bed to bed anche wireless, per parametri emodinamici (anche invasivi) e gas completi per anestesia con analisi aritmie, dotato di registratore.